Mutual Recognition Arrangement MRA 対応

ひずみ校正器（電圧比）の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

直流ひずみ測定器 （データロガー）

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

■ ひずみ校正器（恒久的施設）

	電圧比	校正の不確かさ（k ＝2）
直流	0 mV/V 以上　10 mV/V 以下	0.000 25 mV/V

■ 電圧比測定装置（恒久的施設・現地校正）

	電圧比	校正の不確かさ（k ＝2）
直流（恒久）	0 mV/V 以上　10 mV/V 以下	0.001 6 mV/V
直流（現地）	0 mV/V 以上　10 mV/V 以下	0.003 2 mV/V

※　校正は、電気（電圧比）の校正に限ります。なお、マイナスの電圧比も実施可能です。

※　校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

■ 校正のご利用方法

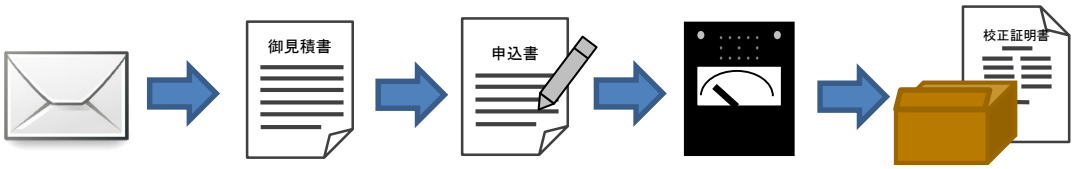

日本電気計器検定所　中部支社　標準課

〒487-0014　愛知県春日井市気噴町三丁目5番地7
TEL：0568-53-6336　　FAX：0568-53-6337
E-Mail：kousei-cub@jemic.go.jp　　URL：https://www.jemic.go.jp

2021.12

※無断転載・複製を禁じます。