Mutual Recognition Arrangement
MRA
対応

電力測定装置の JCSS 校正

校正結果は、ILAC/APACのMRA（相互承認取決）を通じて、国際的に受け入れられます。

■ 対象測定器

ディジタル電力計

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲			拡張不確かさ（信頼の水準約95 %）
電力測定装置	10 V 以上、300 V 以下 250 mA 以上、30 A 以下 50 Hz 、60Hz 力率　全範囲		0.28 mW/VA ～ 0.32 mW/VA
	100 V 50 Hz、60 Hz	100 mA　力率 1	0.010 W
		200 mA　力率 1	0.018 W
無効電力計	10 V 以上、300 V 以下 250 mA 以上、30 A 以下 50 Hz 、60 Hz 力率　全範囲		0.30 mvar/VA ～ 0.38 mvar/VA

関西支社のみ

条件によっては、対応できない場合があります。詳細はお問い合わせください。
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。校正の不確かさは、条件により異なりますので、表記の数値を必ず満たすものではありません。

■ 校正のご利用方法

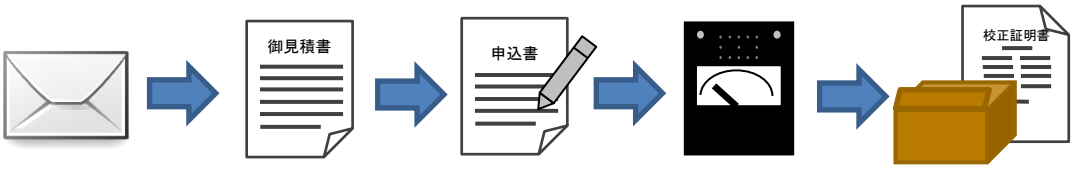

お問い合わせ　→　見積書作成　→　お申し込み　→　校　正　→　納　品

日本電気計器検定所　関西支社　標準課

〒531-0077　大阪府大阪市北区大淀北一丁目6番110号
TEL：06-6451-2356　　FAX：06-6451-2360
E-Mail：kousei-osk@jemic.go.jp　　URL：https://www.jemic.go.jp

2023.6

※無断転載・複製を禁じます。