

# サーモグラフィの校正

## ■ 対象測定器

### サーモグラフィ 熱画像装置




## ■ 校正範囲及び校正の不確かさ

校正範囲	拡張不確かさ(信頼の水準 約95%)
-40℃以上 200℃以下	2.0℃
200℃超過 400℃以下	3.0℃

ディスプレイに温度表示されているものに限ります。  
サーモグラフィの仕様によっては、校正できない場合があります。  
お問い合わせの際は、サーモグラフィの仕様(測定波長、検出器の種類、測定距離と標的サイズ等)をお知らせください。  
校正の不確かさは、校正範囲で一番小さなものを記載しています。

## ■ 校正のご利用方法

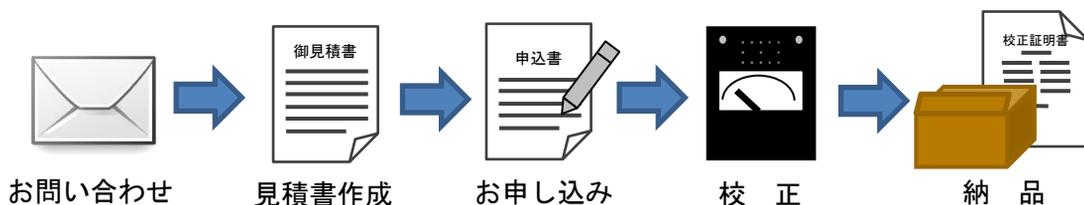

## 日本電気計器検定所 標準部 校正サービスグループ

〒108-0023 東京都港区芝浦四丁目15番7号

TEL : 03-3451-6762 FAX : 03-3451-1497

E-Mail : kousei-info@jemic.go.jp URL : <https://www.jemic.go.jp>